



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzaska 44, 78 – 600 Wałcz



DYREKTOR
lek. Robert SOKOŁOWSKI

Wałcz, dn. 6 maja 2025 r.

Do wiadomości uczestników
postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

„Dostawa obłożeń, odzieży i wyrobów medycznych na blok operacyjny”

Zamawiający na podstawie **art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych** (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) informuje o wpłynięciu do Zamawiającego w terminie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

Dotyczy zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga, aby podkłady ginekologiczne były wykonane z materiałów nadających się do sterylizowania w parze wodnej ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 2 siatek chirurgicznych, polipropylenowych:

- gramatura siatki 50g/m²
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary : 6cmx11cm; 7,5cmx15cm; 15cmx15cm; 20cmx30cm; 30cmx30cm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 3, w pozycji nr 1 Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 µm ;porowatość max.: 2314 µm; grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach zakończonych bezpiecznymi pętelkami, posiadająca trzy markery w środkowej części ułatwiające fiksację taśmy, jeden centralny na całej szerokości taśmy – wyznaczający środek taśmy, dwa krótsze po bokach w odległości 7,5 mm od centralnego i 5mm od osłonek, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), która zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy ? **oraz** 1szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, z niebieską metalową rączką do zakładania przez otwory zasłonowe ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 4

Dotyczy zadania nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 1 produkt o następującej specyfikacji: Małoinwazyjny system do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet, techniką pojedynczego nacięcia.

1. System całkowicie jednorazowy, sterylny
2. Lekka taśma o długości 12 cm wykonana z polipropylenu monofilamentowego, makroporowata
3. Podparcie cewki moczowej zbliżone do tradycyjnych taśm TOT/TVT, nie mniejsze niż 16 cm²
4. W części centralnej niebieski szew umożliwiający precyzyjne umieszczenie taśmy oraz przeznaczony do kontroli napięcia taśmy
5. Opatentowany, bezkotwiczkowy system pozycjonowania „T-Pocket”, który umożliwia jego regulację i zmianę położenia po obu stronach i w obu kierunkach podczas operacji w celu dostosowania do potrzeb pacjentów
6. Możliwość implantacji w znieczuleniu miejscowym

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 2 produkt o następującej specyfikacji:

Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Elastyczna i odporna na rozciąganie, makroporowata, wykonana z niewchłaniającego polipropylenu monofilamentowego w technologii bezwęzłowej z pamięcią kształtu.

Parametry techniczne (przy każdym parametrze dopuszcza się odchylenie w granicach 5%):

- szerokość: 1,2 cm
- długość: 43 cm
- porowatość: 55%
- przestrzenie międzywłóknowe 75-2073 µm
- grubość: 0,47 mm
- gramatura: 60 g/m²

Taśma posiada wzdłużne, pętelkowe zakończenie brzegów niebieską nicią. Końce taśmy są zwężone i zakończone pętlami do podłączenia igieł oraz zapewniające atraumatyczne przejście przez tkanki.

W zestawie znajdują się narzędzia jednorazowego użytku do implantacji przez otwory zasłonię (TOT) w technice out-in i in-out lub z dostępu załonowego (TVT) – do wyboru przez zamawiającego.

System całkowicie jednorazowy, sterylny.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy zadania nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, w pozycji nr 2 : Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 µm; porowatość max.: 2314 µm; grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 µm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), która zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy ?

Oraz

1 komplet igieł spiralnych (prawa+lewa) wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, implantacja przezzasłoniowa ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Pytanie 7

Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 4: Taśmę do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, jednorazową, jednorodną, niewchłaniającą, z polipropylenu monofilamentowego z plastikową osłonką na ramionach, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości 84%, porowatość średnia: 976 μm ; porowatość max.: 2314 μm ; grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 80 μm , gramaturze 48 g/m², wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, atraumatycznych brzegach zakończonych bezpiecznymi pętelkami, wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), która zwiększa wytrzymałość taśmy na rozciąganie we wszystkich kierunkach, co zapobiega zwijaniu się i deformacji taśmy?

oraz

1szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej, z niebieską metalową rączką do zakładania przez otwory zasłonowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy zadania nr 4

Czy Zamawiający dopuści produkt o poniższych parametrach? Taśma urologiczna wytwarzana techniką dziewiarską z transparentnej monofilamentowej przędzy propylenowej, na obydwu końcach zaopatrzona w uchwyty z przędzy monofilamentowej w kolorze niebieskim, pozwalające na bezpieczne zamocowanie na odpowiednim aplikatorze, a także dobrą widoczność w polu operacyjnym. Każdy uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie przed wyrwaniem w postaci rurek termokurczliwych. Masa powierzchniowa taśmy (bez uchwytów) 65-75 g/m², szerokość taśmy 1,1 cm +/- 0,2 cm, grubość nitki 0,16 mm, powierzchnia porów ok. 5,9 mm², długość taśmy (bez uchwytów) 45 cm (+/- 3 cm). Taśma charakteryzuje się bezpiecznymi, atraumatycznymi brzegami, niską masą liniową, biostabilnością, dzięki czemu nie traci właściwości fizycznych podczas długotrwałego kontaktu z tkankami i płynami ustrojowymi, porowatą strukturą minimalizującą ryzyko infekcji bakteryjnej, optymalnie opracowaną strukturą przestrzenną, gdzie wielkość porów umożliwia szybkie przerastanie tkanką łączną. Taśma urologiczna przeznaczona jest do stosowania w chirurgicznym leczeniu nietrzymania moczu u kobiet metodami TVT i TOT, które umożliwiają beznapięciowe założenie implantów syntetycznych.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy zadania nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x60 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy zadania nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 70 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy zadania nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 75x90 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem w rozmiarze 50 x 60 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Pytanie 13

Dotyczy zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem w rozmiarze 75 x 75 cm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy zadania nr 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę trójwarstwową o wymiarach 75x50 cm o gramaturze 72,6g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy zadania nr 5 poz. 5 i 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 65g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Dotyczy zadania nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę wykonanej z laminatu o odporności na przenikanie wody min. 158cm H₂O? Pozostałe parametry serwetę bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Dotyczy zadania nr 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 65 g/m², odporność na przenikanie cieczy 185 cm H₂O ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy zadania nr 5 poz. 7

Czy Zamawiającym dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19

Dotyczy zadania nr 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 50x75cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Dotyczy zadania nr 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści osłonę mayo o wymiarach 79x145cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Dotyczy zadania nr 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści osłonę wykonaną z folii polietylenowej o gramaturze 47 g/m² (0.05 mm). Wzmocnienie części roboczej dwuwarstwowym materiałem Biflex PP min 60 g/m² (rozmiar wzmocnienia 142 cm x 60 cm) o odporności na przenikanie cieczy 185 cm H₂O . Rozmiar 80 x 145 cm ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Pytanie 22

Dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 220 x 280 cm z laminatu dwuwarstwowego 67,5 g/m² (polietylen/ polipropylen) z decentralnie położonym samoprzylepnym otworem 15 x 15 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 23

Dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o następującym składzie i parametrach: 1x serweta okulistyczna 90 x 80 cm z pięciowarstwowej, antystatycznej, hydrofobowej włókniny SSMS 43 g/m² na całej powierzchni, z otworem 10 x 10 cm wypełnionym folią chirurgiczną ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem 1x serweta 100 x 150 cm z laminatu dwuwarstwowego (nieprzemakalna folia + włókninowa warstwa chłonna)- owinięcie zestawu

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę okulistyczną z podwójnym zbiornikiem. Serweta z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy. Gramatura serwety 65g/m². Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład: 1 serweta główna 140 x 150 cm, z otworem 9 x 11 cm wypełnionym folią chirurgiczną. Po dwóch stronach otworu zintegrowane z serwetą prostokątne zbiorniki do przechwytywania płynów wyposażone w kształtki (sztywniki);

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25

Dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu ?

Obłożenie sterylne do operacji okulistycznych

1 Opatrunek foliowy 10 x 12cm z ramką i metką do opisywania

1 serweta okulistyczna 150 x 180 cm (włóknina SMMSS), zintegrowana z 2 torebkami na płyny 22 x 30cm, owalny otwór 5 x 7 cm otoczony 3 sztywnikami

1 Serweta na stół do instrumentarium 150 x 140 cm, wzmocnienie 75x140cm (owinięcie zestawu)- wykonana z folii polietylenowa 50µm z dodatkowym wzmocnieniem włókninowym - 76,6 g/m² (46,6+30 g/m²)

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26

Dotyczy zadania nr 7

Ze względu na przeznaczenie zestawu do stosowania w obrębie sali operacyjnej oraz podczas przeprowadzania procedur chirurgicznych Zamawiający wymaga by zestaw sterylny, pakowany był w opakowanie pośrednie dyspenser kartonowy z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe. Na opakowaniu 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.



Pytanie 27

Dotyczy zadania nr 7


Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie zestawów okulistycznych zawierającej torbę do zbiórki płynów wyposażoną w 1 sztywnik. Proponowany zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Dotyczy zadania nr 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnej obłożenia do operacji okulistycznych o następującym składzie:

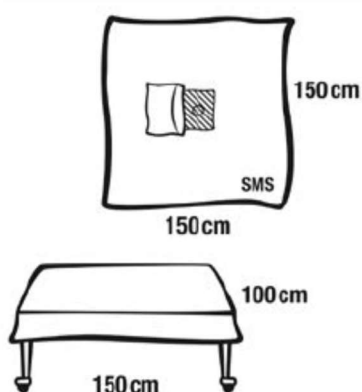

*Zestaw okulistyczny II
z perforowaną folią operacyjną
i kieszenią na płyny

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy 100 x 150

1 serweta okulistyczna SMS
z otworem przylepnym (otwór
10 x 7 cm z folią operacyjną perfo-
rowaną) i workiem na płyny 150 x 150

Serweta okulistyczna oraz serweta na stolik narzędziowy bez dodatkowego wzmocnienia.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 29

Dotyczy zadania nr 8

Prosimy o dopuszczenie :

Serweta na stół narzędziowy w rozmiarze 150x200 cm

Ręczniki w rozmiarze 40x40 cm

Serweta na stolik Mayo w rozmiarze 78x145 cm

Taśma samoprzylepna w rozmiarze 10x 50 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30

Dotyczy zadania nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze podstawowej 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²); odporność na rozerwanie laminatu na sucho/ mokro odpowiednio: 175/ 185 kPa? Zestaw posiada 4 etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji: 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod kreskowy oraz 2 etykiety zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności, dane producenta i kod QR.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 31

Dotyczy zadania nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do zakładania szwów spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, w którym nożyczki metalowe ostro/ostre mają długość 11,4 cm oraz w którego skład wchodzi serwety wykonane z włókny o gramaturze 36 g/m²? Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32

Dotyczy zadania nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do cewnikowania spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37? Skład zestawu zgodny z wymaganiami SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Dotyczy zadania nr 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do wklucia centralnego spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, w którym serweta główna ma rozmiar 150 cm x 120 cm, otwór zgodny z SWZ. Serwety w Zestawie wykonane są z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 55 g/m². Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Dotyczy zadania nr 10 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do znieczulenia przewodowego, spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych w tym przepisów dotyczących systemów lub zestawów zabiegowych zgodne z artykułem 2 ust.10 oraz artykułem 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (MDR) z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych z późniejszymi zmianami w tym artykułem 2 ust. 37, w którym we wszystkich klejących powierzchniach zastosowany jest hipoalergiczny klej na bazie kauczuku syntetycznego, bez dodatku cynku. Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Dotyczy zadania nr 11

Prosimy o dopuszczenie :

Serweta na stół narzędziowy w rozmiarze 150x200 cm

Ręczniki w rozmiarze 40x40 cm

Serweta na stół Mayo w rozmiarze 78x145 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Pytanie 36


Dotyczy zadania nr 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych parametrach:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przylepna 5 x 120cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przylepna wokół wycięcia;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;

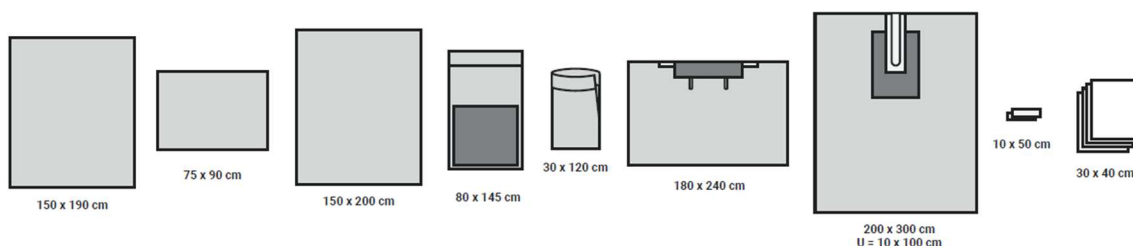

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37

Dotyczy zadania nr 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do kraniotomii o następującym składzie i parametrach:

- 1x serweta dwuwarstwowa do kraniotomii 290 x 220 cm z otworem 22 x 32 cm wypełnionym folią chirurgiczną ze zintegrowanym polietylenowym workiem na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów oraz z sitem i zaworem do podłączenia drenu, z dodatkowym padem chłonnym w strefie krytycznej
- 4x serweta chirurgiczna samoprzylepna 50 x 50 cm dwuwarstwowa
- 1x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 1x taśma lepna włókninowa
- 2x ręcznik do rąk

Odporność na wypychanie laminatu min. 120 kPa. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.


Pytanie 38

Dotyczy zadania nr 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu o składzie:



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz

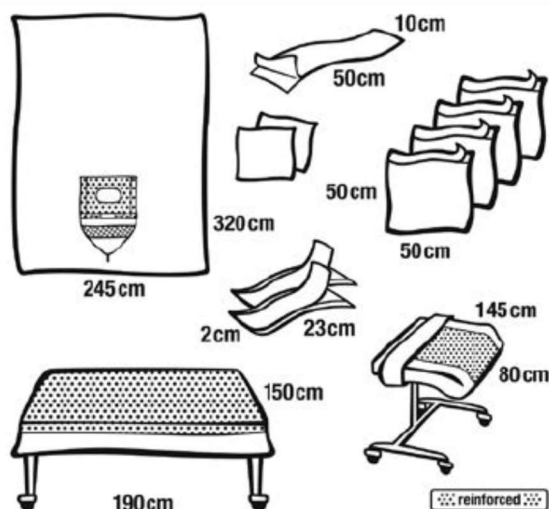

Zestaw neurochirurgiczny II wzmocniony

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta neurochirurgiczna z padem chłonnym i otworem z folią (19 x 30 cm), z torbą do zbierania płynów z sitem i zaworem	320 x 245
4 samoprzylepne serwety operacyjne	50 x 50
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
2 uchwyty Velcro	2 x 23
2 ręczniki celulozowe	30 x 33


Parametry techniczne laminatu (odporność na penetrację płynów, wytrzymałość na rozzerwania) wyższe niż wymagane w SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Dotyczy zadania nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do artroskopii stawu barkowego o składzie:

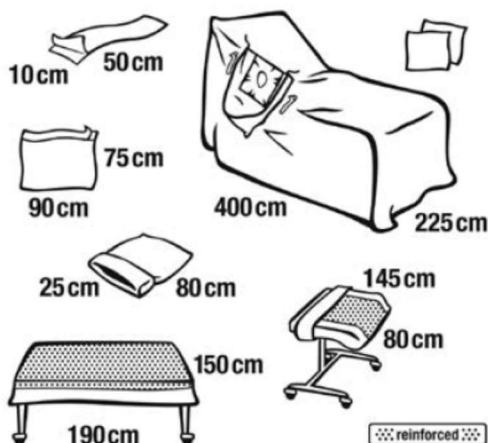

Zestaw do artroskopii barku II

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór 12 cm). Wbudowane dwa uchwyty Velcro	225 x 400
1 samoprzylepna serweta operacyjna	75 x 90
1 osłona na kończynę	25 x 80
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
2 ręczniki celulozowe	30 x 33

Obłożenie wykonane z laminatu o gramaturze 55 g/m². Zestaw pakowany do transportu w dwa kartony. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40

Dotyczy zadania nr 13 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie różnic w pakiecie 13 w pozycji 1:

- Zestaw do artroskopii barku w pozycji siedzącej:
- 2x ręcznik 40x40 cm
- 1x osłona ortopedyczna (elastyczna) na kończynę, krótka 40x75 cm
- 1x serweta do artroskopii stawu barkowego 240x380 cm, z samouszczelniającym się otworem w kształcie gruszki 10x10,5 cm. Reszta wymiarów serwet i parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Pytanie 41

Dotyczy zadania nr 13 poz. 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie zestawów wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² (wymagane 57 g/m²). Produkt spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Dotyczy zadania nr 13 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie :

Serweta na stół narzędziowy w rozmiarze 150x200 cm

Ręczniki w rozmiarze 40x40 cm

Serweta na stolik Mayo w rozmiarze 78x145 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43

Dotyczy zadania nr 13 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie :

Serweta na stół narzędziowy w rozmiarze 150x200 cm

Ręczniki w rozmiarze 40x40 cm

Serweta na stolik Mayo w rozmiarze 78x145 cm

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44

Dotyczy zadania nr 13 poz. 2

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o dopuszczenie zestawów wykonanych z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m² (wymagane 57 g/m²). Produkt spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45

Dotyczy zadania nr 13 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie różnic w pakiecie 13 w pozycji 2:

– Zestaw serwet do operacji dłoni/stopy:

- 2x ręcznik 40x40 cm

- serweta Mayo 80x145 cm ze wzmocnieniem 60x145 cm

- 1x serweta operacyjna dłoni/stopa 240x300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 3 cm

- serweta instrumentalna 150x190 cm, ze wzmocnieniem 100x190 cm

Reszta wymiarów serwet i parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie 46

Dotyczy zadania nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do operacji dłoni/stopy, o składzie:



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz

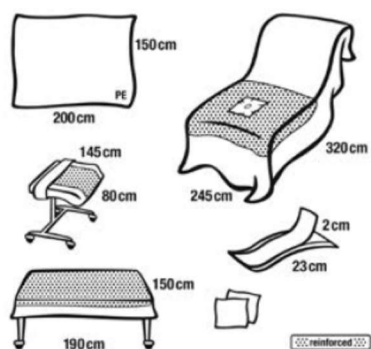

Protect Plus zestaw do operacji dłoni/stopy III

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona (opakowanie zestawu)	190 x 150
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145
2 ręczniki celulozowe	33 x 30
1 Protect Plus serweta do operacji dłoni/ stopy, otwór 3 cm	245 x 320
1 uchwyt Velcro	2 x 23
1 serweta PE	150 x 200

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 55 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 100 cm x 150 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 110 g/m². Chłonność materiału podstawowego 285%, chłonność obszaru wzmocnionego 350%.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 47

Dotyczy zadania nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu o chłonności materiału podstawowego 340%, chłonność obszaru wzmocnionego 348% ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 48

Dotyczy zadania nr 13 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę, z jedną taśmą lepłą pakowana oddzielnie, niezależnie od osłony. Pozostałe parametry osłony bez zmian.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 49

Dotyczy zadania nr 13 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13 w pozycji 3:

- osłony sterylnej na kończynę 40x75 cm

Reszta wymiarów i parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 50

Dotyczy zadania nr 13 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 13 w pozycji 4:

- osłony sterylnej na kończynę 50x120 cm

Reszta wymiarów i parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 51

Dotyczy zadania nr 13 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę, z dwiema taśmami lepłymi pakowanymi oddzielnie, niezależnie od osłony. Pozostałe parametry osłony bez zmian.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 52

Dotyczy zadania nr 14 poz. 1



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Czy Zamawiający dopuści materiał serwet głównych dwuwarstwowy na całej powierzchni PE+PP (grubość folii 29µm) o gramaturze 55 g/m² w części podstawowej. Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 118 cm H₂O Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 53

Dotyczy zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu ?

Zestaw serwet uniwersalny

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

1 x osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66x85cm,

2 x ręcznik do rąk 30,5 x 34cm

2 x serwety przylepne 75 x 90 cm

1 x serweta przylepna 180 x 180 cm

1 x serweta przylepna 150 x 240 cm

1 x serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał serwet głównych dwuwarstwowy na całej powierzchni PE+PP (grubość folii 29µm) o gramaturze 55 g/m² w części podstawowej.


Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 144,5 kPa/ 147,3 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 115 cm H₂O. Zgodnie z normą EN 13795-1:2019.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Dotyczy zadania nr 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu uniwersalnego o składzie:

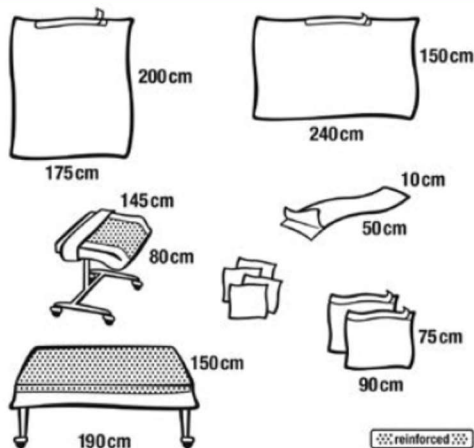

Zestaw uniwersalny IV

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	150 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna	150 x 240
1 samoprzylepna serweta operacyjna	200 x 175
2 samoprzylepne serwety operacyjne	75 x 90
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Serweta na stół Mayo ma wzmocnienie w rozmiarze 80cm x 145cm.

Materiał serwet głównych dwuwarstwowy na całej powierzchni PE+PP (grubość folii 60µm) o gramaturze 55 g/m². Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 134/145 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 158 cm H₂O. Pozostałe parametry zestawu bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Dotyczy zadania nr 14 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie :

Serweta na stół narzędziowy w rozmiarze 150x200 cm

Ręczniki w rozmiarze 40x40 cm

Serweta na stół Mayo w rozmiarze 78x145 cm



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz

Taśma samoprzylepna w rozmiarze 10x 50 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 56

Dotyczy zadania nr 14 poz. 1


Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych parametrach:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy

- Gramatura serwet 65 g/m²
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 180 cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 150 x 240 cm;
- 2 serwety z taśmą przylepną 75 x 100 cm;
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

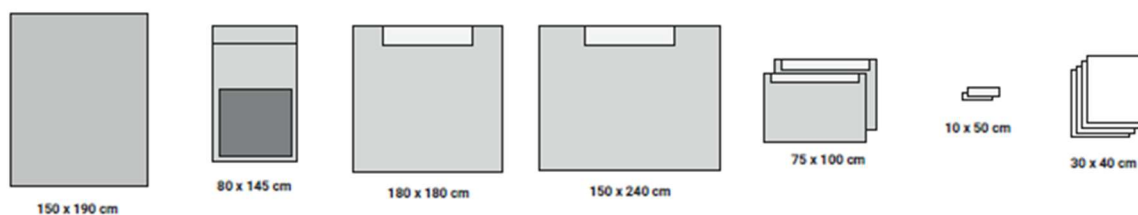

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 57

Dotyczy zadania nr 14 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie **Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych**. Skład zestawu:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50μ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem, składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku

1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m², dobrze układającego się na pacjencie, odpornego na przenikanie płynów > 175 cm H₂O) odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145 kPa), niepyłącego (współczynnik pylenia ≤ 1,7 log₁₀). W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy zabezpieczającymi część lepna serwet pozwalające w rękawicach jednych ruchem odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzaska 44, 78 – 600 Wałcz



zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58

Dotyczy zadania nr 14 poz. 2

W związku z zapisem w serwetach głównych dodatkowej warstwy chłonnej czy Zamawiający wymaga by serwety wykonane były z laminatu trójwarstwowego na całej powierzchni PE+PP+PE (grubość folii 19µm) o gramaturze 65g/m² w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 55 g/m².

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 157,2 kPa / 160,1 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 140 cm H₂O. Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019.

Wymagany minimalny skład zestawu:

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

1 x osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66x85cm

4 x ręcznik do rąk 30,5 x 34cm

2 x serweta 75 x 90 cm z taśmą przylepną 4,5x85cm, padem chłonnym 25x60cm i organizatorami przewodów

1x serweta średnia 180 x 180 cm z taśmą przylepną 4,5x85cm, padem chłonnym 25x60cm i organizatorami przewodów

1 x serweta duża 150 x 240 cm z taśmą przylepną 4,5x85cm, padem chłonnym 25x60cm i organizatorami przewodów

1 x serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 59

Dotyczy zadania nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet uniwersalny wzmocniony

1 x taśma przylepna 9 x 50 cm

1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo 79x145 cm, wzmocnienie 66 x 85cm

4 x ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 x serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 x serweta przylepna 180 x 180 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 x serweta przylepna 150 x 240 cm z padem chłonnym 25 x 60 cm i organizatorami przewodów

1 x serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał serwet głównych dwuwarstwowy na całej powierzchni PE+PP (grubość folii 19µm) o gramaturze 55 g/m² w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 65g/m².

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym min. 160/157 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 140 cm H₂O.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 60

Dotyczy zadania nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²) ? Serweta przylepna na ekran anestetyczny ma rozmiar 150 x 250 zamiast 150 x 240 cm i posiada zintegrowane oraganizatory przewodów. Pozostałe serwety mają wymiary zgodne z SWZ. Serwety boczne i serweta dolna bez organizatorów przewodów. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m² (+/- 0,5 g/m²).

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Pytanie 61

Dotyczy zadania nr 14 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie :

Serweta na stół narzędziowy w rozmiarze 150x200 cm

Ręczniki w rozmiarze 40x40 cm

Serweta na stolik Mayo w rozmiarze 78x145 cm

Taśma samoprzylepna w rozmiarze 10x 50 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 62

Dotyczy zadania nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu uniwersalnego wzmocnionego o składzie:

- 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm, wzmocnienie 80cm x 145cm
- 4 x ręczniki do osuszania rąk 30cm x 33cm
- 2 x serwety przylepne 75 x 90 cm z padem chłonnym 25cm x 90cm
- 1 x serweta przylepna 200cm x 200 cm z padem chłonnym 75cm x 50cm
- 1 x serweta przylepna 150cm x 240cm z padem chłonnym 75cm x 50cm
- 1 x serweta na stół do instrumentarium 150cm x 190cm, wzmocnienie 75cm x 190cm

Materiał serwet głównych dwuwarstwowy na całej powierzchni PE+PP (grubość folii 60µm) o gramaturze 55 g/m² w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 110g/m².

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 353/339 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 204 cm H₂O.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 63

Dotyczy zadania nr 14 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie **Sterylny zestaw uniwersalny ze wzmocnieniem** . Skład zestawu:

1x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm z folii PE 50µm ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

1x serweta na stolik Mayo 80x142 cm z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu 55x88cm , składana rewersowo

2x serweta boczna 90x75 cm, ze wzmocnieniem 60x25 cm z przylepcem o długości 84cm

1x serweta dolna 175x190 cm, ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1x serweta górna 240x150 cm ze wzmocnieniem 67x25 cm z przylepcem o długości 98 cm, ze zintegrowanym podwójnym organizatorem przewodów

1x taśma lepna włókninowa 9X50 cm

4x ręcznik chłonny celulozowy 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

Tolerancja rozmiarów dla serwet okrywających pacjenta +/-2 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m² odpornego na penetrację płynów (>175 cmH₂O, odpornego na rozerwanie na mokro/sucho (min. 145kPa) o niskim współczynniku pylenia (**współczynnik pylenia $\leq 1,7\log_{10}$**). W obszarze krytycznym wzmocnienie chłonne pozbawione pyłących włókien wiskozy i celulozy (polipropylen 60 g/m²), o łącznej gramaturze w 121 g/m². Nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepna ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. I klasa palności. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylne w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Sterylizacja tlenkiem etylenu.

Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Pytanie 64


Dotyczy zadania nr 14 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych parametrach:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65 g/m²
- Serwety wzmocnione dodatkowym padem chłonnym
- Uniwersalne zastosowanie
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z 1 organizatorem przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100 cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60 cm, taśma przylepna 5 x 100 cm;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

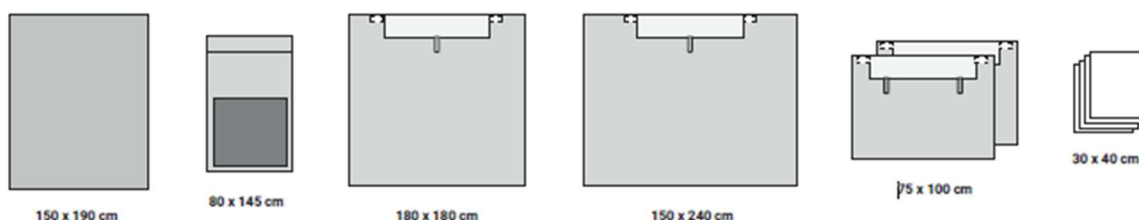

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 65

Dotyczy zadania nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższych parametrach:


- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Gramatura serwet 65g/m²
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;
- 1 serweta 75 x 90cm;
- 1 serweta 150 x 200cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 120cm;
- 1 serweta z taśmą przylepną 180 x 240cm z 2 organizatorami przewodów w formie rzepu, pad chłonny 30x60cm, taśma przylepna 5 x 120cm;
- 1 serweta główna 200 x 300cm, z wycięciem U-kształtnym w rozmiarze 10x100 cm, pad chłonny w rozmiarze 50x100 cm, taśma przylepna wokół wycięcia;
- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50cm;
- 4 ręczniki 30 x 40cm;



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz

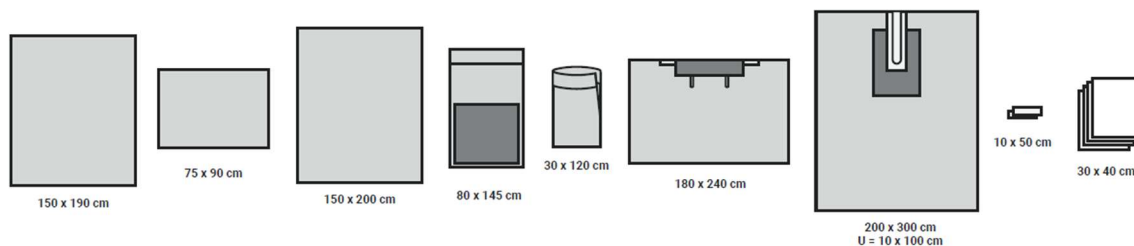

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 66

Dotyczy zadania nr 14 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie **Sterylny zestaw uniwersalny Skład zestawu:**

2x osłona na stół narzędziowy, 152x190 cm (jedna stanowi owinięcie zestawu)

1x osłona na stół Mayo, 80x142 cm, z wytrzymałym wzmocnieniem heavy duty

2x ręcznik chłonny, 30x20 cm, rozłożone

2x taśma lepna, 9x50 cm

1x serweta 90x75 cm, przylepna

1x serweta 220x300 cm z przylepnym wycięciem w kształcie U 8,5x107 cm, ze wzmocnieniem 100x50 cm, m

1x serweta górna 260x182 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 25x67 cm, z przylepcem o długości 110 cm

Serwety okrywające pacjenta, wykonane z chłonnego (na całej powierzchni) bilaminatu o niskiej gramaturze max. 58g/m² i wysokiej odporności przenikanie płynów > 170 cm H₂O, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7log₁₀. W celu ułatwienia aplikacji serwety złożone książkowo, z nieprzylepnymi końcówkami przy taśmach zabezpieczającymi część lepna serwet pozwalające w rękawicach odkryć część lepna do aplikacji serwet na pacjencie. I klasa palności.

Zestaw pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem kreskowym. Zestawy zbiorczo pakowane w worek foliowy, następnie karton. Sterylizacja EO. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzony certyfikatem.


Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 67

Dotyczy zadania nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu serwet z serwetą główną wycięciem „U” o składzie:

z

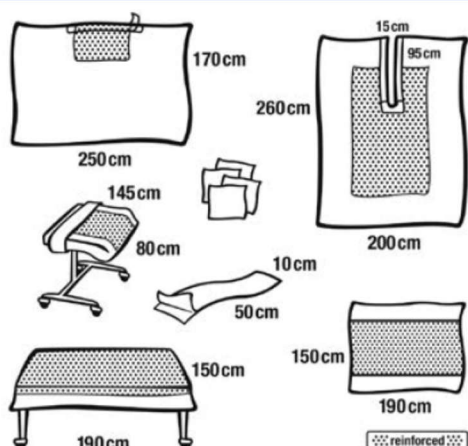

Uniwersalny zestaw z serwetą U 3
wzmocniony

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona (opakowanie zestawu)	190 x 150
1 serweta na stolik Mayo	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna typu „U” (15 x 95 cm) z padem chłonnym	260 x 200
1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym	250 x 170
1 serweta operacyjna wzmocniona	190 x 150
4 ręczniki celulozowe	33 x 30
1 taśma przylepna	10 x 50

Serweta na stolik Mayo ma wzmocnienie w rozmiarze 80 cm x 145cm

Pad chłonny w serwecie z wycięciem „U” jest w rozmiarze 150cm x 160cm Materiał serwet głównych dwuwarstwowy PP+PE (grubość folii 60µm) o gramaturze 55 g/m² w części podstawowej. W części krytycznej serwet pad chłonny o gramaturze 110g/m². Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 353/339 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 204 cm H₂O.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 68

Dotyczy zadania nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet z serwetą z wycięciem U

- 1 x taśma przyklepna 9 x 50 cm
1 x osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66x85cm
4 x ręcznik do rąk 30,5 x 34cm
1 x przyklepna serweta 75 x 90 cm
1 x serweta 225 x 260cm z przyklepnym wycięciem 'U' 10x100cm z padem chłonnym 75x140cm
1 x przyklepna serweta 150 x 240 cm
1 x serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał serwet głównych trzywarstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 19µm) o gramaturze 65 g/m2 w części podstawowej. W serwecie głównej pad chłonny o gramaturze 55g/m2.

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 157,2 kPa/ 160,1 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 140 cm H₂O.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69

Dotyczy zadania nr 14 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie :

Serweta na stół narzędziowy w rozmiarze 150x200 cm

Reczniki w rozmiarze 40x40 cm

Serweta na stół Mayo w rozmiarze 78x145 cm

Taśma samoprzylepna w rozmiarze 10x 50 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 70

Dotyczy zadania nr 14 poz. 3



**107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu**
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/- 0,5 g/m²)? W serwecie z wycięciem U wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarze 110 x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m².

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 71

Dotyczy zadania nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę 225 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm. Materiał serwet głównych trzywarstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 19µm) o gramaturze min. 55 g/m² w części podstawowej. W serwecie głównej pad chłonny o gramaturze 55g/m².

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym min. 148/145 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 125 cm H₂O.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 72

Dotyczy zadania nr 14 poz. 1,2,3

Ze względu na przeznaczenie zestawu do stosowania w obrębie sali operacyjnej oraz podczas przeprowadzania procedur chirurgicznych Zamawiający wymaga by zestaw sterylny, pakowany był w opakowanie pośrednie dyspenser kartonowy z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego.

Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe. Na opakowaniu 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 73

Dotyczy zadania nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Zestaw serwet do operacji kończyn

2 x taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 x ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 x elastyczna osłona na kończynę 36 x 65 cm

1 x serweta do operacji kończyn 225 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 x serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał serwety głównej trzywarstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 29µm) o gramaturze 55 g/m² w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 55g/m².

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym min. 148/145 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) min. 125 cm H₂O.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 74

Dotyczy zadania nr 15 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie :

Serweta na stół narzędziowy w rozmiarze 150x200 cm

Ręczniki w rozmiarze 40x40 cm

Serweta na stolik Mayo w rozmiarze 78x145 cm

Taśma samoprzylepna w rozmiarze 10x 50 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 75

Dotyczy zadania nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²). Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109 g/m². Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 273/283 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 174 cm H₂O.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 76

Dotyczy zadania nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do operacji kończyn o następującym składzie i parametrach:

2x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm- wzmocnienie min. 64 x 145 cm

4x ręcznik do rąk 43x30 (+/- 3 cm)

1x osłona na kończynę 35 x 80 cm dwuwarstwowa

1x serweta chirurgiczna dwuwarstwowa 150 x 180 cm

1x serweta do operacji kończyn 220 x 320 cm dwuwarstwowa 67,5 g/m² z elastycznym otworem 7 x 5 cm oraz z dodatkowym padem chłonnym 50 x 115 cm wokół otworu oraz ze zintegrowanym uchwytem typu rzep (velcro)

1x serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm- wzmocnienie 64 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwety obłożenia pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min. 67 g/m² - w tym folia polietylenowa 25 µm. Łata chłonna w serwecie do operacji kończyny o gramaturze min. 94 g/m² - łączna gramatura w obszarze krytycznym min. 161 g/m². Odporność na wypychanie w strefie krytycznej na sucho/ mokro odpowiednio: min. 289/136 kPa. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 540 cm H₂O. Poziom absorpcji (chłonność) > 470%.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77

Dotyczy zadania nr 15 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie :

Serweta na stół narzędziowy w rozmiarze 150x200 cm

Ręczniki w rozmiarze 40x40 cm

Serweta na stolik Mayo w rozmiarze 78x145 cm

Taśma samoprzylepna w rozmiarze 10x 50 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Pytanie 78

Dotyczy zadania nr 15 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do operacji kończyn

2 x taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 x osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66x85cm

4 x ręcznik do rąk 30,5 x 34cm

1 x osłona na kończynę 36 x 65cm

1 x serweta 150 x 190 cm

1 x serweta do operacji kończyn 225 x 300cm z elastycznym otworem o średnicy 7cm, padem chłonnym 50 x 100cm i organizatorami przewodów

1 x serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Materiał serwety głównej trzywarstwowy na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 19µm) o gramaturze 65 g/m2 w części podstawowej + łata chłonna o gramaturze 55g/m2.

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho w obszarze krytycznym 157,2 kPa/ 160,1 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 140 cm H2O.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 79

Dotyczy zadania nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej serwetki do artroskopii kolana o następującym składzie i parametrach:

2x taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

1x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm - wzmocnienie min. 64 x 145 cm

4x ręcznik do rąk 43x30 (+/- 3 cm)

1x osłona na kończynę 35 x 80 cm dwuwarstwowa

1x serweta chirurgiczna 150 x 180 cm dwuwarstwowa na całej powierzchni, składana, mogąca służyć za serwetę na stół instrumentariuszki

1x serweta do artroskopii kolana 220 x 320 cm dwuwarstwowa 67,5 g/m2 na całej powierzchni z elastycznymi otworami 7 i 5 cm, ze zintegrowanym polietylenowym workiem na płyny ze sztywnikiem do formowania brzegów oraz z sitem i zaworem do podłączenia drenu oraz ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

1x serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm- wzmocnienie 64 x 190 cm (owinięcie zestawu)

Serwetki obłożenia pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min. 67 g/m2 - w tym folia polietylenowa 25 µm. Odporność na wypychanie na suchy/mokro min. 120/ 152 kPa. Odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H2O na całej powierzchni. Poziom absorpcji (chłonność) > 290%.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80

Dotyczy zadania nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści elastyczną osłonę na kończynę 36 x 65 cm?

Materiał serwety głównej dwuwarstwowej na całej powierzchni PP+PE (grubość folii 33µm) o gramaturze 60g/m2

Odporność na rozerwanie na mokro/sucho min 143/ 144 kPa.

Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 81

Dotyczy zadania nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu do operacji kończyn w następującym składzie:

1 serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm



**107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu**
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



2 ręczniki 30 cm x 40 cm
1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm
1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm
1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm
1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm
1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep
Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²). Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 185/175 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 129 cm H₂O.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 82

Dotyczy zadania nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw serwet do artroskopii kolana

2 x taśmy przylepne 9 x 50 cm
1 x osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 66x85cm
4 x ręcznik do rąk 30,5 x 34cm
1 x osłona na kończynę 36 x 65cm
1 x serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75x190cm (składana)
1 x serweta do artroskopii kolana 230 x 320 z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5cm
1 x serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
Materiał serwety głównej na całej powierzchni PP+PE+PP (grubość folii 33µm) o gramaturze 60 g/m²
Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 139,8 kPa/ 136,8 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność)
245 cm H₂O.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 83

Dotyczy zadania nr 15 poz. 1, 2

Ze względu na przeznaczenie zestawu do stosowania w obrębie sali operacyjnej oraz podczas przeprowadzania procedur chirurgicznych Zamawiający wymaga by zestaw sterylny, pakowany był w opakowanie pośrednie dyspenser kartonowy z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 84

Dotyczy zadania nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Zestaw do cystoskopii

2 x legginsy (osłony na kończyny) 75 x 120 cm
1 x serweta do cystoskopii 100 x 175 cm z otworem przylepnym 9 x 15 cm
1x Serweta na stół do instrumentarium 100 x 150cm (owinięcie zestawu)
Materiał serwety głównej i osłon na kończyny dwuwarstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 29µm) o gramaturze 55g/m²
Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 144,5 kPa/ 147,3 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 115 cm H₂O



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 85

Dotyczy zadania nr 16

Ze względu na przeznaczenie zestawu do stosowania w obrębie sali operacyjnej oraz podczas przeprowadzania procedur chirurgicznych Zamawiający wymaga by zestaw sterylny, pakowany był w opakowanie pośrednie dyspenser kartonowy z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe. Na opakowaniu 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 86

Dotyczy zadania nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu w następującym składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm 2 długie osłony na kończyny dolne 75x120cm 1 serweta do ginekologii/cystoskopii 90 cm x 175 cm z otworem na krocze 9 cm x 15 cm otoczonym taśmą lepłą, umieszczonym centralnie. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m² (+/-0,5 g/m²). Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 185/175 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 129 cm H₂O.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 87

Dotyczy zadania nr 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego zestawu do cystoskopii o następującym składzie i parametrach:

2x osłona na kończynę 75 x 120 cm dwuwarstwowa na całej powierzchni

1x serweta do cystoskopii 75 x 175 cm z otworem 9 x 15 cm przylepnym dwuwarstwowa na całej powierzchni

1x serweta na stolik narzędziowy 100 x 150 cm dwuwarstwowa na całej powierzchni

Serwety obłożenia pacjenta z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze całkowitej min. 67 g/m² - w tym folia polietylenowa 25 µm. Odporność na wypychanie na sucho/mokro min. 120/ 152 kPa. Odporność na przenikanie cieczy min. 240 cm H₂O. Poziom absorpcji (chłonność) > 290%.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 88

Dotyczy zadania nr 16

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii o następujących parametrach:

2 x legginsy (osłony na kończyny) 75 x120 cm

1 x serweta do cystoskopii 180 x 75cm z otworem przylepnym 20x10 cm, wycięcie półokrągłe

1x serweta na stół do instrumentarium 190 x 150 cm, szerokość warstwy chłonnej 66 cm

1 x serweta 90 x75 cm

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.


Pytanie 89

Dotyczy zadania nr 16

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu do cystoskopii o składzie:



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz

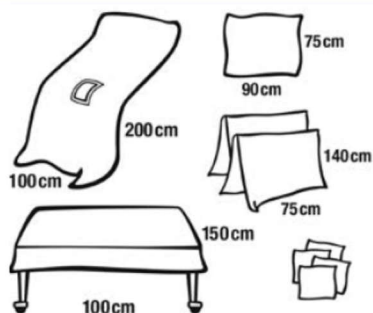

Zestaw ginekologiczny III

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy Protect	100 x 150
1 samoprzylepna serweta ginekologiczna z otworem (7 x 10 cm)	200 x 100
1 serweta nieprzylepna	75 x 90
2 osłony na kończynę długie	75 x 140
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Materiał serwety głównej i serwety nieprzylepnej, serwety na stolik narzędziowy i osłon na kończyny jest dwuwarstwowy PE+PP na całej powierzchni (grubość folii 60µm) o gramaturze 55g/m² Odporność na rozerwanie na mokro/sucho 134/145 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 158 cm H₂O.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 90

Dotyczy zadania nr 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160 x 210 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 91

Dotyczy zadania nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 80 x 160 cm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92

Dotyczy zadania nr 17 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkłady w innym kolorze.

Pytanie 93

Dotyczy Zadanie nr 17, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kolor niebieski? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne kolory.

Pytanie 94

Dotyczy Zadanie nr 18, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło bez nitek? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 95

Dotyczy Zadanie nr 18, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści perforację co 38 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96

Dotyczy Zadanie nr 18, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści perforację co 50 cm? Pozostałe wymagania zgodne z SWZ
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Pytanie 97

Dotyczy zadania 20 poz. 1

Czy zamawiający oczekuje fartuch wyłącznie włókninowy czy włókninowy podfoliowany lub włókninowy wzmocniony z przodu i na rękawach ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje fartuch wyłącznie włókninowy.

Pytanie 98

Dotyczy zadania 20 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 Jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego zgodnego z normą EN 13795 - 1:2019 wykonanego z włókniny typu wodoodpornej; co najmniej trójwarstwowej polipropylenowej typu SMMMS, gramatura min.35g/m². Odporny na działanie płynów. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzące za siebie. Zapięcie na górze w formie rzepów, pozwalające na aplikację w obrębie rzepa na karku. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowanie aseptycznego – pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Opakowanie z dwoma rękawkami, fartuch zawinięty w serwetę włókninową zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem. Rozmiary od M do XXL.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99

Dotyczy zadania nr 20 poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza fartuch zgodnie z opisem ?

Fartuch sterylny, pełnobarierowy

- wykonany z niebieskiej włókniny SMS 35 g/m²
- nie zawiera wiskozy ani celulozy
- szwy ultradźwiękowe
- rękaw wszywany typu reglan zakończony elastycznym mankietem z dzianiny bawełnianej o długości 7,5 cm
- tylne części fartucha zachodzące na siebie
- para troków zewnętrznych umiejscowiona w dwukolorowym kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania
- druga para troków wewnętrznych
- rzep przy szyi o wymiarach 3 x 10 cm oraz 3 x 5 cm (+/- 3 mm)
- nadruk lub metka rozmiaru w widocznym miejscu przed rozłożeniem
- złożenie fartucha umożliwiając aseptyczne założenie (książkowe)
- owijka fartucha wykonana z włókniny SMS 25 g/m² o wymiarach 60 x 60 cm
- w zestawie 2 rękawiczki o wymiarach 30 x 40 cm
- - wypychanie na sucho 99,3 kPa, na mokro 99,1 kPa
- rozciąganie na sucho wzdłuż 69,48 N, w poprzek 44,24 N; na mokro wzdłuż 88,5 N, w poprzek 45,48 N
- pyłność log10 ≤4,0
- penetracja płynu 40 cmH₂O
- rozmiary:
 - S 115 x 140 cm
 - M 125 x 145 cm
 - L 130 x 150 cm
 - XL 140 x 160 cm
 - XXL 160 x 160 cm
- zgodny z MDR 2017/745, EN 13795-1, EN ISO 11135-1, EN 556-1:2001
- wskaźnik sterylizacji na opakowaniu
- Na opakowaniu dwie samoprzylepne naklejki transferowe z kodami kreskowymi zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, LOT oraz datę ważności
- opakowanie zbiorcze (karton) dodatkowo zabezpieczone workiem wewnętrznym



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 100

Dotyczy zadania nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuchy z niepylającej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2, ze standardowym rzepem przy szyi w zmian taśmy ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101

Dotyczy zadania nr 20 poz. 2

Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW, 0115-KDST1-2.440.172.2024.6.AR, 0115-KDST1-2.440.173.2024.7.AR oraz aktualnym Komunikatem Prezesa Urzędu z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej: <https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/komunikat-prezesa-urzedu-z-dnia-24-maja-2024-r-w-sprawie-zasad-okre%C5%9Blania-statusu-regulacyjnego> według których fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?

2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLW MiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętymi stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

3. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej.

Pytanie 102

Dotyczy zadania nr 20 poz. 2

Czy zamawiający dopuści fartuchy niesterylne z mankietem, fartuch wykonany z włókniny min. 20 g/m2, rękaw zakończony gumką lub mankietem z elastycznym ściągaczem, fartuch stanowiący barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany z tyłu na troki, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 103

Dotyczy zadania nr 20 poz. 2

Czy zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104

Dotyczy zadania nr 20 poz. 2

Czy zamawiający oczekuje i wymaga produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny, gdyż fartuchy będą używane zarówno przez pacjentów na terenie szpitala w procedurach medycznych jak i przez personel medyczny w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i stosowany w procedurach medycznych; fartuch spełniający normy: Klasa wyrobu: I, Reguła 1 (Załącznik VIII MDR) ROZPORZĄDZENIE (UE) 2017/745; ISO 13485:201, EN13795-1 ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I, zgodnie z Komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zasad określania statusu regulacyjnego odzieży medycznej.



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Pytanie 105

Dotyczy zadania 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy o gramaturze min. 20 g/m²?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106

Dotyczy zadania nr 20 poz. 2

Czy zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze 20g/m² ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 107

Dotyczy zadania nr 21

Zwracamy się o możliwość złożenia: Sterylna osłona na przewody jednorazowego użytku wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubości 50µm, elastyczna końcówka, 2 zintegrowane przylepce o wym. 15x244cm.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 108

Dotyczy zadania nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na przewody jednorazowego użytku wykonanej z przezroczystej folii polietylenowej o grubości 35µm, z elastyczną końcówką, w rozmiarze 18x244 ± 1 cm, wyposażonej w pasek lepny do mocowania na przewodach w rozmiarze 15,5 x 1 cm.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109

Dotyczy zadania nr 21

Czy Zamawiający dopuści Sterylna osłona na przewody jednorazowego użytku wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubości 40µm, elastyczna końcówka, 2 zintegrowane przylepce o wymiarach 15x240 cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 110

Dotyczy zadania nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony w rozmiarze 16 x 250 cm, zakończoną kartonem, z foliową taśmą lepłą na końcu osłony do zamocowania na przewodzie ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 111

Dotyczy zadania nr 21

Ze względu na przeznaczenie osłony do stosowania w obrębie sali operacyjnej oraz podczas przeprowadzania procedur chirurgicznych Zamawiający wymaga by osłona sterylna, pakowana była w opakowanie pośrednie dyspenser kartonowy z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe. Na opakowaniu 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 112

Dotyczy zadania nr 21

Prosimy o dopuszczenie Sterylnej, jednorazowej osłony na przewody o szer. 18 cm oraz dł. 244 cm, wykonany z mocnej folii PE 50 µm, z elastyczną zwężającą się końcówką, z taśmą lepłą 1,8x20 cm do fiksacji na głowicy i dodatkowym przylepcem paskowym 15 cm z drugiej strony osłony.



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 113

Dotyczy zadania nr 21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej osłony? Sterylna osłona na przewody jednorazowego użytku wykonana z przezroczystej folii polietylenowej o grubości 40µm, elastyczna końcówka, 2 zintegrowane przylepce.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 114

Dotyczy zadania nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej osłony ? Osłona na aparaturę Ø 140cm ściągnięta elastyczną gumką 100-240 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 115

Dotyczy zadania nr 22

Ze względu na przeznaczenie osłony do stosowania w obrębie sali operacyjnej oraz podczas przeprowadzania procedur chirurgicznych Zamawiający wymaga by osłona sterylna, pakowana była w opakowanie pośrednie dyspenser kartonowy z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe. Na opakowaniu 4 repositionowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 116

Dotyczy zadania nr 22

Zwracamy się o możliwość złożenia : Sterylna osłona na aparaturę medyczną w kształcie kuli, z gumką; rozmiar w stanie rozciągniętym 122x122cm.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117

Dotyczy zadania nr 22

Czy Zamawiający dopuści Sterylna osłona na aparaturę medyczną w kształcie kuli, z gumką; rozmiar o średnicy 90 cm o rozciągliwości 60-166cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 118

Dotyczy zadania nr 22

Czy Zamawiający dopuści Sterylna osłona na aparaturę medyczną w kształcie kuli, z gumką; rozmiar o średnicy 140 cm o rozciągliwości 100-240cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 119

Dotyczy zadania nr 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony na aparaturę RTG w kształcie kuli o średnicy 120 cm (po naciągnięciu) ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120

Dotyczy zadania nr 23 poz. 1



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na głowice USG dla anestezjologii, z żelem sterylnym, z dwoma gumkami i dwoma taśmami, w rozmiarze 13x61 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121

Dotyczy zadania nr 23 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie **Sterylny zestaw do osłony sondy z żelem**. Skład zestawu:

- 1 osłona sondy 61x15 cm, wykonana z przezroczystego poliuretanu
- 1 żel ultradźwiękowy 20g
- 2 elastyczne gumki
- 1 serweta z miękkiej włókniny SMS (owinięcie zestawu),

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122

Dotyczy zadania nr 23 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie **Sterylny zestaw do osłony sondy z żelem**. Skład zestawu:

- 1 osłona sondy 122x15 cm, wykonana z przezroczystego poliuretanu
- 1 żel ultradźwiękowy 20g
- 2 elastyczne gumki
- 1 serweta z miękkiej włókniny SMS (owinięcie zestawu),

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123

Dotyczy zadania nr 23 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej osłony na głowice USG dla anestezjologii, bez sterylnego filmu samoprzylepnego w rozmiarze 15 x 122 ± 1 cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 124

Dotyczy zadania nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej kieszeni? Kieszeń sterylna z folii, samoprzylepna, jednokomorowa 30x40.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125

Dotyczy zadania nr 24

Ze względu na przeznaczenie kieszeni do stosowania w obrębie sali operacyjnej oraz podczas przeprowadzania procedur chirurgicznych Zamawiający wymaga by kieszeń sterylna, pakowana była w opakowanie pośrednie dyspenser kartonowy z perforowanym jednym brzegiem oraz karton transportowy – w celu zapewnienia bezpieczeństwa transportu i przechowywania w warunkach bloku operacyjnego. Opakowanie jednostkowe papierowo-foliowe. Na opakowaniu 4 repozycjonowalne etykiety samoprzylepne zawierające nr REF, LOT, datę ważności, nazwę marki, dodatkowo na 2 etykietach kod UDI. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca obrazkowo elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie 126

Dotyczy zadania nr 24

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni sterylnej w rozmiarze 43 cm x 38 cm? Pozostałe parametry kieszeni bez zmian.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Pytanie 127

Dotyczy zadania nr 24

Prosimy o dopuszczenie kieszeni na narzędzia w rozmiarze 33x41 cm

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128

Dotyczy zadania nr 24


Czy Zamawiający dopuści kieszeń w rozmiarze 30 x 40 cm?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 129

Dotyczy zadania nr 25

Czy Zamawiający dopuści Zbiornik na płyny 50 x 50 cm: Sterylny, jednorazowego użytku. Wykonany z nieprzemakalnej folii PE (grubość 0,05mm), zaopatrzony jest w taśmę lepłą, filtr oraz sztywnik. Opakowanie a'1 szt. typu folia-papier Trzy naklejki z m.in. kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie

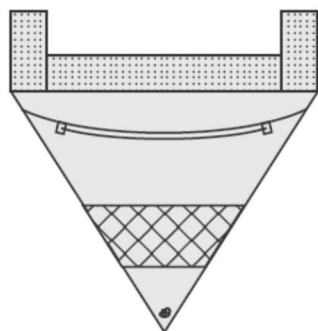

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 130

Dotyczy zadania nr 25

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kieszeni do przechwytywania płynów w rozmiarze 56 cm x 90 cm? Pozostałe parametry kieszeni bez zmian.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 131

Dotyczy zadania nr 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej torby do przechwytywania płynów zgodnej z SWZ, z tą różnicą, że ma wymiar 80x55 cm?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 132

Dotyczy zadania nr 27 poz. 1

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty : Mata na podłogę, o dużej wchłaniałości (minimum 1,4l) płynów, z możliwością przytwierdzenia do podłogi w 4 miejscach. Materiał: Laminat wykonany z chłonnej masy celulozowej i połączonej z nią folią polietylenową. O wymiarach 81cm x 152cm. Gramatura min. 100g/m2. Ilość w opakowaniu 25 szt.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 133

Dotyczy zadania nr 27 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 27 pozycji 1 dopuści matę podłogową w rozmiarze 75x180 cm o chłonność 2 l/m2 z zachowaniem reszty SWZ ?



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 134

Dotyczy zadania nr 27 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maty chłonnej w rozm. 71,1x182,8 cm. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 135

Dotyczy zadania nr 27 poz. 2

Zwracamy się o możliwość złożenia oferty : Mata na podłogę, o dużej wchłaniałości (minimum 1,4l) płynów, z możliwością przytwierdzenia do podłogi w 4 miejscach. Materiał: Laminat wykonany z chłonnej masy celulozowej i połączonej z nią folią polietylenową. O wymiarach 81cm x 122cm. Gramatura min.100g/m². Ilość w opakowaniu 25 szt.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 136

Dotyczy zadania nr 27 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 27 pozycji 2 dopuści jednostronną matę podłogową w rozmiarze 72x37 cm składającą się z dwóch warstw –pierwsza warstwa hydrofilowy polipropylen, druga warstwa SAP, absorbująca wszystkie rodzaje płynów –chłonność wody do 9l lub 3,5l NaCl ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 137

Dotyczy zadania nr 28 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie Rękawice chirurgiczne lateksowe pudrowane średnia grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,17 mm, na mankiecie 0,15 mm, średnia siła zrywania przed starzeniem 14 N, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 138

Dotyczy zadania nr 28 poz. 1

Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 pozycja nr 1 dopuści rozwiązanie równoważne Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem z mikroteksturą, mankiet rolowany. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4. Typowa grubość na palcu 0,22 mm+/-0,03mm, na dłoni 0,18 mm+/-0,03mm, na mankiecie 0,15+/-0,02 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 290 mm. Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa producenta, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R) ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 139

Dotyczy zadania nr 28 poz. 2

Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 pozycja nr 2 dopuści rozwiązanie równoważne: Rękawice chirurgiczne sterylne, lateksowe, bezpudrowe z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna gładka z wykończeniem mikroteksturovanym, mankiet rolowany. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4. Typowa grubość na palcu 0,22 mm+/-0,03mm, na dłoni 0,18 mm+/-0,03mm, na mankiecie 0,15+/-0,02 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 290 mm. Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa producenta, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R) ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 140

Dotyczy zadania nr 28 poz. 3



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 pozycja nr 3 dopuści rozwiązanie równoważne: Rękawice chirurgiczne bezlateksowe, warstwa wewnętrzna hydrofobowo hydrofilową powłoką ułatwiającą szybkie zakładanie na wilgotne i suche dłonie bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, średnia grubość: na palcu 0,22 mm+/-0,02mm, na dłoni 0,20 mm+/-0,02mm, na mankiecie 0,20 mm+/-0,02mm, długość min. 290 mm dla każdego rozmiaru, średnia siła zrywania min. 17 N. AQL po zapakowaniu 0,65, anatomiczne. Mankiet prosty z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa producenta, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R) ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141

Dotyczy zadania nr 28 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 pozycja nr 3 dopuści rozwiązanie równoważne: Rękawice chirurgiczne syntetyczne: poliizoprenowe, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, średnia grubość: na palcu 0,23 mm, na dłoni : $\geq 0,17$ mm, na mankiecie $\geq 0,17$ mm, długość min. 287-300 mm (w zależności od rozmiaru), średnia siła zrywania min. 19 N. AQL po zapakowaniu 0,65, anatomiczne. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R) ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 142

Dotyczy zadania nr 28 poz. 4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 pozycja nr 4 dopuści rozwiązanie równoważne: Rękawice chirurgiczne poliizoprenowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą Pokryte warstwą CPC (Cetylpyridinium chloride), Darvan L i silikonu, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość na palcu 0,23 mm, na dłoni : $\geq 0,17$ mm, na mankiecie $\geq 0,17$ mm, AQL max. 0,65, kształt anatomiczny Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, długość min. 287-300 mm (w zależności od rozmiaru). Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 143

Dotyczy zadania nr 28 poz. 5

Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 pozycja nr 5 dopuści rozwiązanie równoważne: Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, lateksowe bezpudrowe o podwyższonej chwytności z powłoką polimeru z hydrofobowo hydrofilową pozwalającą na szybkie zakładanie na wilgotne i suche dłonie, dodatkowo silikonowane. Typowa grubość: na palcu 0,33+/-0,03mm, na dłoni 0,31+/-0,03mm, na mankiecie 0,25+/-0,03mm, długość min. 290mm, średnia siła zrywania min. 29 N. AQL 0,65, anatomiczne, brązowe. Mankiet rolowany z opaską lepną adhezyjną zapobiegającą zsuwaniu się rękawicy z mankietu. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1 ?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 144

Dotyczy zadania nr 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj.: dreny pompy i membrany używane z drenem (poz. 3 i 4 formularza cenowego), które spełniają wszystkie wymagane parametry techniczne i są przeznaczone przez producenta do pracy w środowisku szpitalnym, jednak nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2022 poz. 974), a zatem nie podlegają obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE, dla których stawka VAT wynosi 23% ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 145

Dotyczy zadania nr 30



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Czy w związku z tym, że opisane w poz. 5-6 formularza cenowego pętle i elektrody są pakowane przez producenta w opakowania zbiorcze po 6 szt. i nie zaleca się ich rozpakowywania, Zamawiający dokona modyfikacji jednostki miary ze sztuk na opakowania oraz skoryguje wymaganą ilość w przeliczeniu na opakowania ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 146

Dotyczy zadania nr 30

Czy ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia oraz fakt że towar znajduje się w magazynie zewnętrznym poza granicami kraju, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy dla zadania nr 30.

Pytanie 147

Dotyczy zadania nr 31 poz. 6

Czy Zamawiający (wzorem lat poprzednich) dopuści do zaoferowania: jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, współpracujące z generatorem GEN11, zamykające naczynia do 7 mm, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 38 mm, długość ramienia 20 cm, rotacja pełna 360 stopni, końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 148

Dotyczy wzoru umowy § 2 pkt. 3:

Czy zamawiający może potwierdzić, że materiały opatrunkowe nie są wyrobami ratującymi życie pacjentów I w związku z tym termin dostaw na Cito w ciągu 24h nie dotyczy pakietów zawierających materiały opatrunkowe?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Pytanie 149

Dotyczy wzoru umowy § 4 pkt. 1:

Czy zamawiający zgodzi się na skrócenie czasu rękojmi do 3 miesięcy? Materiały opatrunkowe, których dotyczyć będzie umowa są łatwo policzalne I równie łatwo jest sprawdzić ich jakość przyjmując towar z dostawy.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 150

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do 20% ogólnej wartości Umowy. Ustalenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych na poziomie 30% wynagrodzenia wykonawcy należy uznać za nadużycie przez zamawiającego prawa do jednostronnego kształtowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz działanie sprzeczne z zasadami współzycia społecznego (art. 353(1) kc). Ułatwienie zamawiającemu dochodzenia odszkodowania nie powinno skutkować tym, że wykonawca będzie obowiązany do zapłaty zamawiającemu kar umownych w wysokości zbliżonej do wynagrodzenia za realizację umowy w sytuacji, gdy szkoda zamawiającego będzie znacznie mniejsza. Oczywiście zamawiający powinien być uprawniony do uzyskania pełnego pokrycia szkody wyrządzonej mu przez wykonawcę w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, jednakże temu służy instytucja uregulowana w art. 484 § 1 zd. 2 kc (tzw. kara zaliczalna). Na podstawie tego przepisu możliwe jest dokonanie w umowie zastrzeżenia, zgodnie z którym wierzyciel uprawniony jest do dochodzenia, obok kary umownej, odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 151

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1 pkt. 1.2



107 Szpital Wojskowy
z Przychodnią SPZOZ w Wałczu
ul. Kołobrzeska 44, 78 – 600 Wałcz



Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary do 0,5 % wartości niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Przewidziana kara jest wygórowana w stosunku do wagi naruszenia. Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat. Wskazana przez Zamawiającego wysokość kary jest niewspółmierna do poziomu zawinienia Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zatwierdzam
/-/ Robert Sokołowski
Dyrektora Szpitala